

Allergia DicoCARE CQI e DicoCARE VEQ



MP09-02 Rev.1 del 30/03/09



Valutazione IgE Totali e Specifiche Anti-allergeni Inalanti e Alimenti

Disporre di campioni che rispettano Linee Guide Regionali (es. Reg. Lombardia, Piemonte), di Organismi Internazionali (es. CLSI) e di Società Scientifiche (es. SIBioC) garantisce di validare con tranquillità anche le sedute analitiche per IgE totali e IgE Specifiche

Sai che per il controllo CQI si devono impiegare materiali **DIVERSI** (Terza Parte) da quelli del produttore di strumento e kit diagnostico, usati per la calibrazione (Linee Guida SIBioC, CLSI, Reg. Lombardia) ?



Care S.r.l. non produce kit IgE e IgE Specifiche ed è l'**UNICO** produttore mondiale di Terza Parte di controlli CQI per test IgE e IgE Specifiche

DicoCARE CQI Allergia (Cod. CA-CQIALL)

- Terza Parte:** CQI prodotto da Azienda non produttrice di kit IgE e IgE Specifiche
- Commutabilità:** veri sieri umani, minimamente trattati (= matrice umana)
- Utilità:** due diversi livelli di concentrazione
- Praticità:** 10 aliquote da 1 mLx 2 livelli, in provette barcodeate
- Val. assegnati:** per i più diffusi test IgE Totali ed IgE Specifiche del commercio
- Sensibilità:** anche livelli di 3° Generazione per IgE Specifiche (0,1 - 0,35 kU/L)

NUOVO FORMATO 2009 !!!

- Analiti:** IgE Totali e IgE Specifiche per 14 allergeni di 7 gruppi: Alimenti (F13 arachide; F17 nocciola; F25 pomodoro; F49 mela), Alberi, Dermatofagoidi, Epiteli, Erbe infestanti, Graminacee, Muffe
- Stabile:** 2 anni dalla produzione; 3 giorni dalla ricostituzione
- Efficace:** consente di generare Carte di controllo IMMULITE
- Unico:** consente la partecipazione al programma DicoCARE di CQI allargato (Inter-Laboratorio) (*)

(*) accesso in Tempo Reale con applicazione web DicoCARE Online (online.dicocare.org)

CARE S.r.l. (Gruppo Finsystems S.r.l.) Via Adamoli, 441 16165 Genova (Italy)


CAP.SOC. € 110.000,00 I.V. - COD.FISC. 05923960156 - PART.IVA 03437570108 - C.C.I.A.A. GENOVA 344190 - TRIB DI GENOVA 59718

E se utilizzi i test IgE Specifiche IMMULITE e benefici della Sensibilità Funzionale di 3° Generazione (0.1 kU/L) ...

... perché non impieghi Controlli CQI che consentano di monitorare prestazioni analitiche ai livelli adeguati ?

Con i Controlli DicoCARE CQI Allergia è confermato un CV tra le serie <20 % per risultati <0,35 kU/L dei test 3gAllergy IMMULITE

I Controlli DicoCARE CQI Allergia consentono la conferma di precisione ed esattezza dei valori <0,35 kU/L dei test 3gAllergy IMMULITE

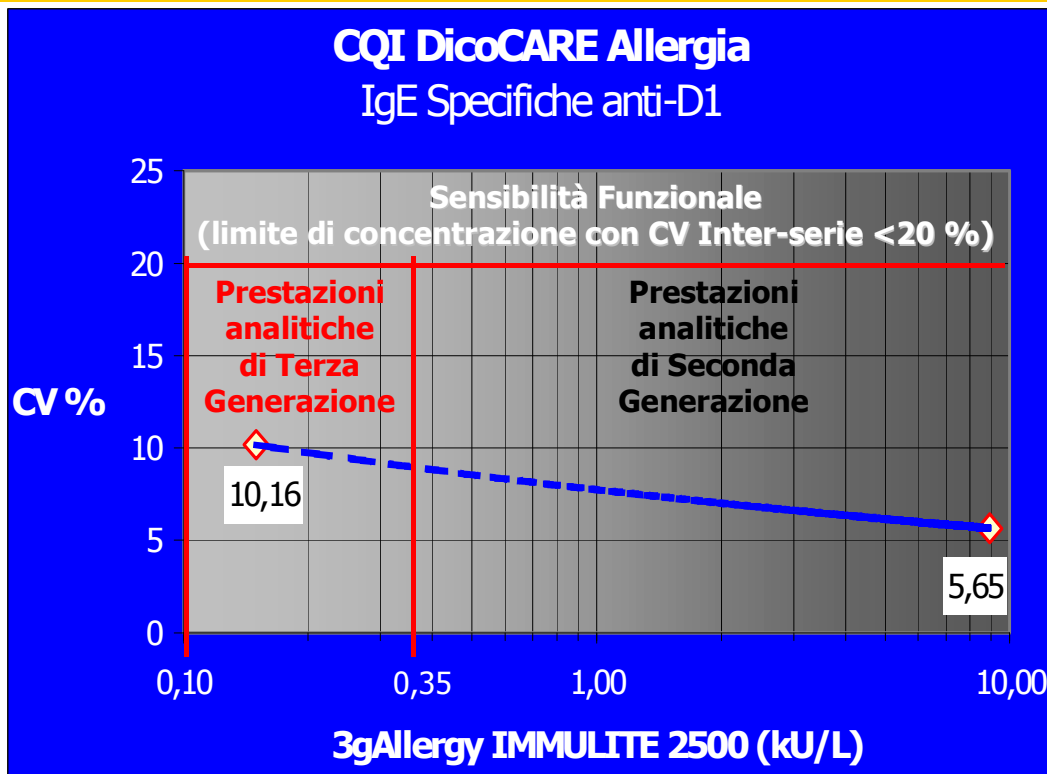

PRECISIONE INTER-SERIE 3gAllergy IMMULITE 2500. Dati CQI con utilizzo dei sieri di controllo DicoCARE CQI Allergia nella routine quotidiana. Totale n. 280 replicati testati nel periodo: Gennaio 2006 – Febbraio 2007. Gentile concessione del Dr. GianLuigi Devoto, Direttore Laboratorio Analisi Ospedale di Lavagna Asl 4 Chiavarese, GE

QC OnCall - [Altri, DPC IMMULITE 2500]

Laboratorio: 706095 IMMULITE
 Numero di Lotto: R052_CTR ALLERGIA Sistema Plasma
 Test: D1, DPC IMMULITE 2500, Reattivi kit dedicati, kU/L.
 Regole: 1-3s(W) R-4s(W) 4-1s(W)MR

Data e Ora	Serie	Livello 1			Livello 2			Riferimento	OP	Nota Intervento
		Valore	A	Regole	Valore	A	Regole			
284	27/12/06 11:57	8	8.95	S	0.16				dm	
285	28/12/06 11:12	1	8.59	S	0.15				dm	
286	29/12/06 11:12	2	8.62	S	0.17				dm	
287	30/12/06 11:13	3	8.62	S	0.15				dm	
288	02/01/07 11:47	1	8.81	S	0.15				dm	
289	03/01/07 11:50	2	9.00	S	0.15				dm	
290	04/01/07 11:50	3	8.99	S	0.15				dm	
291	05/01/07 11:50	4	8.33	S	0.16				dm	
292	08/01/07 11:50	5	8.33	S	0.14				dm	
293	09/01/07 10:17	1	8.11	S	0.14				Adm	

Campione di controllo di 3° Generazione per IgE specifiche !!!
CV medio: 10.2% su 283 replicati !!!

Dati Riassuntivi	Mese		Cumulativo	
	Media	DS	Media	DS
Media	9.09	0.36	8.92	0.50
DS	0.36	0.36	0.50	0.01
CV	3.96	3.96	5.65	5.75
Punti	23	23	283	23

Media Fissa DS: /
 Reference Valore: /

Server - PCBIORAD Database - QCDAO Operatore - Admin

Tratto da: CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DIAGNOSTICO. IL CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNO. Dr. Pasquale Iandolo, Laboratorio Analisi Ospedale di Lavagna Asl 4 Chiavarese, GE. Master in Allergologia. Diagnostica Allergologica in Vitro. 15 Febbraio 2007, Acqui Terme (AL)

CARE S.r.l. (Gruppo Finsystems S.r.l.) Via Adamoli, 441 16165 Genova (Italy)

CAP.SOC. € 110.000,00 I.V - COD.FISC 05923960156 - PART.IVA 03437570108 - C.C.I.A.A. GENOVA 344190 - TRIB DI GENOVA 59718